PanGas AG, avril 2014

Avertissement de sécurité concernant l'utilisation du régulateur BM

Madame, Monsieur, chers professionnels de la santé,

En accord avec Swissmedic, PanGas aimerait attirer votre attention sur l'importance d'un branchement correct du régulateur BM.

Synthèse:

Le régulateur BM est utilisé sur tous les garrots pneumatiques courants pour la réduction de pression, de même que pour tous les raccords de perceuse courants en combinaison avec une alimentation centralisée en air comprimé sans huile.

PanGas a été informé récemment d'un cas dans lequel un garrot pneumatique avait été relié par erreur au raccord pour la perceuse. Il en a résulté qu'elle a explosé sous la pression trop élevée de l'air. Les raccords mâles et les manchons ont été conçus pour éviter pareille erreur de manipulation . Nous ignorons encore pourquoi un tel raccordement serré a pu être réalisé. Si le régulateur BM est utilisé correctement, il demeure tout à fait possible de continuer de s'en servir.

C'est la raison pour laquelle nous tenons à attirer votre attention de manière pressante sur le mode d'utilisation correct du régulateur BM.

Procéder aux réglages de base:

Pour pouvoir identifier clairement les raccords, tenez le régulateur BM de manière à ce que le **manomètre (4)** soit **vertical**. Dans cette position, le raccord destiné au garrot pneumatique est dirigé obliquement, celui destiné à la perceuse est dirigé verticalement vers le bas.

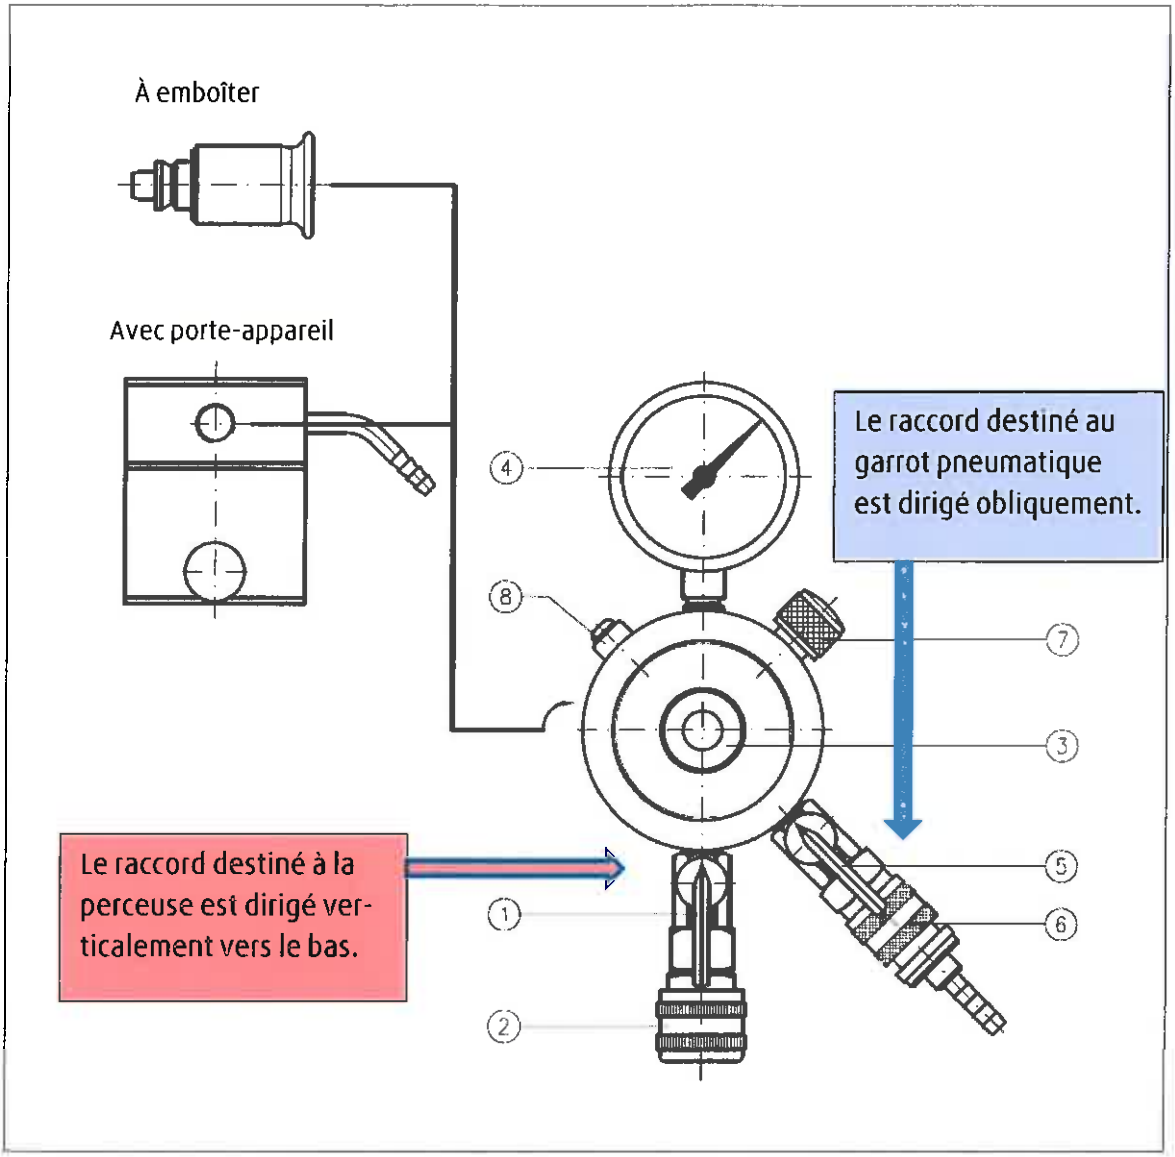

Veuillez tenir compte des autres instructions données dans le mode d'emploi correspondant et respecter les consignes de sécurité figurant dans ce dernier.

Procéder à un essai de fonctionnement avant toute utilisation sur un patient.

Nous vous serions gré de bien vouloir communiquer ces informations à tous les professionnels de la santé de votre établissement.

Cordialement.

Dr. Piero Angelo Marangi
Country Manager Healthcare

Dr. Judith Braun
Quality & Regulatory Affairs Manager
RT Commerce de gros